


# CarbonTech V2 / by Mano Médical

• Matelas chauffant

Pour une prise en charge  
toujours plus sûre et plus rapide !

EFFICACITÉ  
FIABILITÉ  
SÉCURITÉ



# Pourquoi utiliser le matelas chauffant CarbonTech V2 ?



## En préventif

Le maintien de la température corporelle est essentiel, aussi bien lors d'une anesthésie qu'en réanimation. La température des patients baisse chez tous les patients sans exception lors d'une anesthésie.

Conséquences possibles d'un refroidissement :

- ▶ Réveil difficile
- ▶ Risque de choc
- ▶ Risque d'insuffisance rénale ou de problèmes cardiaques
- ▶ Dans certains cas, mort du patient

Ceci se vérifie lors de toutes les interventions, y compris les interventions dites bénignes telles qu'un détartrage.

Plus l'animal est petit, plus le risque d'hypothermie est élevé. Les NAC sont particulièrement concernés.



## En curatif

L'hypothermie consécutive à un choc ou à une anesthésie est à traiter systématiquement. En phase de réanimation, il est important de maintenir la température corporelle aussi proche que possible des 38°C.

Le matelas chauffant Carbon Tech réchauffe le patient en douceur, sans danger et sans risque de brûlure.

L'utilisation du matelas Carbon Tech et le contrôle régulier de la température du patient lors d'une anesthésie et durant la réanimation sont des gestes simples mais indispensables.



## Deux modèles disponibles :

Modèle cage : 52 x 62 cm (+/- 1 cm) - Puissance : 25W  
Modèle table : 52 x 112 cm (+/- 1 cm) Puissance : 50W



# Confort optimum, sécurité maximale



## Dispositif de sécurité intégré

CarbonTechV2 dispose d'une **sonde de température et d'un limiteur précis**, permettant d'assurer que la température de contact ne dépasse pas les limites de sécurité (42°C - 107,6°F)

Extra plat, le tissu carbone de Carbon Tech ne stocke pas de chaleur, **évitant ainsi tout risque de brûlure.**

Pour encore plus de sécurité, CarbonTech V2 se coupe automatiquement après 12 heures d'utilisation.

Nouveau

42°C  
MAXIMUM

3 NIVEAUX  
DE PUISSANCE  
(50, 80 ET 100%)

CHAUFFE  
EN  
5 MINUTES



## Efficacité immédiate longue durée

Le CarbonTech V2 atteint sa température de régulation **en moins de 5 minutes.**


Le CarbonTech V2 est conçu pour **maintenir la température** nécessaire au réchauffement de l'animal **durant de longues périodes.**

## Technologie Carbon Tech

Carbon Tech V2 intègre un tissu carbone haute densité, spécialement conçu pour **diffuser la chaleur de façon homogène.**

Sa structure souple **épouse parfaitement la forme de l'animal** et lui apporte ainsi **un maximum de confort.**

TISSU  
CARBONE  
HAUTE  
DENSITÉ



## Pratique, robuste et hygiénique

Un système d'attaches permet de fixer le transformateur du matelas sous la table de chirurgie afin de **sécuriser l'environnement de travail.**

Le revêtement de Carbon Tech est conçu pour **résister aux griffures et aux morsures** et garantit une **parfaite étanchéité.**

Carbon Tech **se nettoie simplement à l'eau et au savon.** Après séchage, il **se désinfecte facilement à l'alcool.**

Nouveau

CÂBLE  
DÉTACHABLE  
POUR FACILITER  
LE NETTOYAGE



## Les plus du Carbon Tech V2

- ▶ Puissance augmentée pour atteindre plus rapidement la température de chauffe
- ▶ Régulation de la température en toute sécurité (capteur intégré)
- ▶ Extinction de sécurité après 12 heures de chauffe



Mano  
Médical

Medical equipment for veterinarians

15, rue du Noroît  
22100 Taden - France  
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

welcome@manomedical.com

www.manomedical.com




# Données techniques



## Caractéristiques

- ▶ Sonde intégrée avec capteur de température
- ▶ Limiteur de température intégré (42°C)
- ▶ 3 niveaux de puissance (50%, 80% et 100%)
- ▶ Coupure automatique après 12 heures de chauffe
- ▶ Cable d'alimentation déconnectable
- ▶ Alimentation électronique universelle de 100 à 240V
- ▶ Tension utile 24V continue
- ▶ Tissu carbone haute densité
- ▶ Revêtement souple, résistant, simple à entretenir.


Nouveau

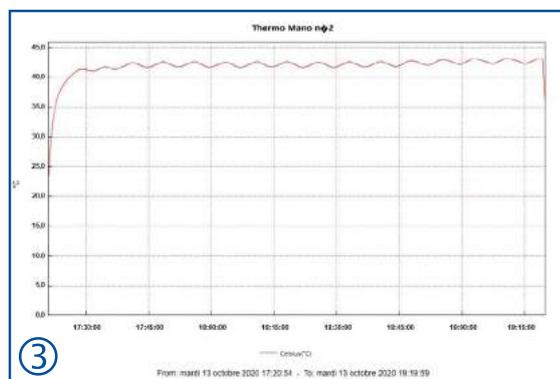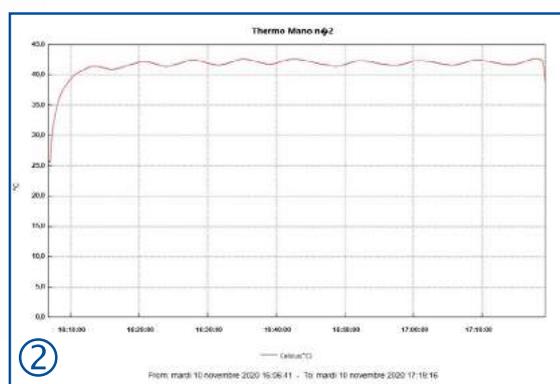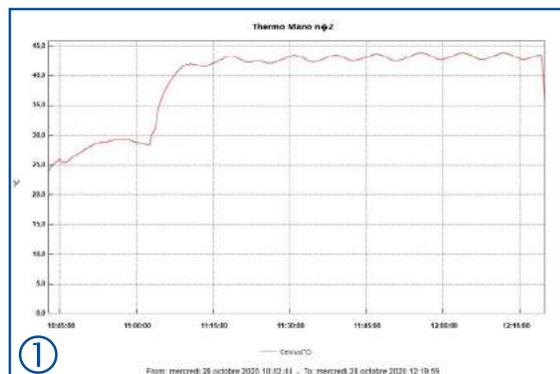

## Résultats cliniques

Les tests cliniques ont montré que l'utilisation des limiteurs de température permet d'optimiser la chauffe pour mieux combattre l'hypothermie.

- ① Chat de 4 kg - intervention de 1h40  
Température avant l'intervention 38,4°C  
Température en fin d'intervention : 38,1°C
- ② Caniche de 9 kg - intervention de 1h10  
Température avant l'intervention 37,8°C  
Température en fin d'intervention : 37,7°C
- ③ Labrador de 40 kg - intervention de 2h00  
Température avant l'intervention 38,7°C  
Température en fin d'intervention : 38,2°C

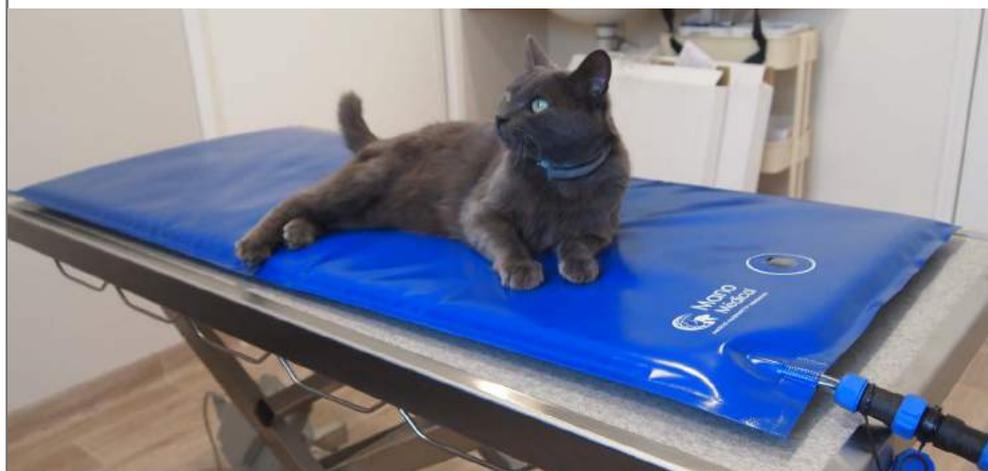

15, rue du Noroît  
22100 Taden - France  
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

welcome@manomedical.com

www.manomedical.com